



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИКА
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 14934—88
(СТ СЭВ 6147—87)

Издание официальное

63 9—88/6237

10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИКА

ГОСТ

Термины и определения

14934—88

Ophthalmic optics. Terms and definitions

(СТ СЭВ 6147—87)

ОКСТУ 4401, 9401

Дата введения 01.07.89

Настоящий стандарт устанавливает термины, определения и буквенные обозначения понятий офтальмологической оптики.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

1. Стандартизованные термины и определения приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина не допускается.

2.1. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.2. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк.

2.3. В случаях, когда отдельные понятия представлены только буквенными обозначениями, термин не приведен и в графе «Термин» поставлен прочерк.

2.4. В табл. 1 к некоторым терминам приведены чертежи.

2.5. В табл. 1 приведены буквенные обозначения понятий офтальмологической оптики.

3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен в табл. 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1989

2-3248

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

ГОСТ 14934-88

Страница: 2/26

4. Алфавитный указатель буквенных обозначений приведен в табл. 3.

5. Термины и пояснения понятий геометрической оптики, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении 2.

6. Единицы измерения в офтальмологической оптике приведены в приложении 3.

7. Основные формулы, применяемые в офтальмологической оптике, приведены в приложении 4.

8. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым.

Таблица 1

Термин	Буквенное обозначение	Определение
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ		
1. Офтальмологическая оптика	—	Наука о глазе как оптической системе и оптических средствах для исследования, лечения и коррекции зрения
2. Очкивая оптика	—	Раздел офтальмологической оптики об оптических средствах коррекции зрения и защиты глаза
ГЛАЗ		
3. Дальнейшая точка ясного зрения	R	Наиболее далекая точка в пространстве предметов, резкое изображение которой получается на сетчатке глаза (retina) при отсутствии напряжения аккомодации
4. —	aп	Расстояние от передней главной точки глаза до дальнейшей точки ясного зрения
5. Амстрапия	Aп	Величина, обратная расстоянию в метрах от передней главной точки глаза до дальнейшей точки ясного зрения
6. —	zп	Расстояние от передней вершины роговицы (согласно) глаза до дальнейшей точки ясного зрения
7. —	Sп	Величина, обратная расстоянию в метрах от передней вершины роговицы до дальнейшей точки ясного зрения
8. Аккомодация глаза	—	Непроизвольный акт, осуществляющийся для получения на сетчатках глаз резких изображений предмета при изменении его расстояния от глаз
9. Ближайшая точка ясного зрения	P	Наиболее близкая точка в пространстве предметов, резкое изображение которой получается на сетчатке глаза при максимальном напряжении аккомодации глаза
10. —	aр	Расстояние от передней главной точки глаза до ближайшей точки ясного зрения

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение	Определение
11. Максимальное напряжение аккомодации глаза	A_p	Величина, обратная расстоянию в метрах от передней главной точки глаза до ближайшей точки ясного зрения
12. —	s_p	Расстояние от передней вершины роговицы глаза до ближайшей точки ясного зрения
13. —	S_p	Величина, обратная расстоянию в метрах от передней вершины роговицы до ближайшей точки ясного зрения
14. Точка фиксации глаза	E	Точка в пространстве предметов, на которую направлен взгляд наблюдателя
15. —	a_E	Расстояние от передней главной точки глаза до точки фиксации глаза
16. Напряжение аккомодации глаза	A_E	Величина, обратная расстоянию в метрах от передней главной точки глаза до точки, находящейся в пределах области аккомодации глаза
17. —	s_E	Расстояние от передней вершины роговицы глаза до точки фиксации глаза
18. —	S_E	Величина, обратная расстоянию в метрах от передней вершины роговицы глаза до точки фиксации глаза
19. Область аккомодации глаза	A_{pE}	Расстояние между дальнейшей и ближайшими точками ясного зрения
20. Объем аккомодации глаза	A_{pE}	Разность между аметропией и максимальным напряжением аккомодации глаза.
		П р и м е ч а н и е . Объем аккомодации вычисляется по формуле
		$A_{pE} = A_E - A_p = \frac{1}{a_E} - \frac{1}{a_p} \quad (1)$
21. Объем аккомодации корригированного глаза	$A_{pE,1}$	—
22. Зрительная ось	—	Линия, соединяющая середину центральной имки сетчатки глаза (foveola) с точкой фиксации глаза
23. Астигматизм глаза	A_s	Разность аметропий в главных сечениях глаза
24. Диаметр входного зрачка глаза	D_p	Диаметр наблюдаемого через роговицу изображения истинного зрачка глаза
25. —	d_p	Расстояние от передней вершины роговицы до центра входного зрачка глаза
26. —	d_{z_p}	Расстояние от передней вершины роговицы до оптического центра вращения глаза
27. Толщина роговицы	d_o	Расстояние от передней до задней вершины роговицы


2*

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение	Определение
28. Глубина передней камеры	d_{OL}	Расстояние от задней вершины роговицы до передней вершины хрусталика (lens crystallina)
29. Толщина хрусталика глаза	d_L	Расстояние от передней до задней вершины хрусталика глаза
30. Оптическая длина глаза	d_{OD}	Расстояние вдоль оптической оси от передней вершины роговицы до сетчатки глаза
31. Межзрачковое расстояние для дальни	r_y	Расстояние между центрами зрачков глаз при зрении вдаль
32. —	$r_{F,R}$	Расстояние от середины переноса до центра зрачка правого глаза при зрении вдаль
33. —	$r_{F,L}$	Расстояние от середины переноса до центра зрачка левого глаза при зрении вдаль
34. Межзрачковое расстояние для близи	r_x	Расстояние между центрами зрачков глаз при зрении на расстоянии наилучшего зрения
35. —	$r_{N,R}$	Расстояние от середины переноса до центра зрачка правого глаза при зрении на расстоянии наилучшего зрения
36. —	$r_{N,L}$	Расстояние от середины переноса до центра зрачка левого глаза при зрении на расстоянии наилучшего зрения
37. —	δ	Расстояние от задней главной точки очковой линзы до передней главной точки глаза
38. —	$\bar{\delta}$	Расстояние от задней вершины очковой линзы до передней вершины роговицы
39. Видимый угловой размер предмета	ω_1	Угол между прямыми, проведеными из передней узловой точки глаза к крайним точкам предмета
40. Угловое разрешение некорригированного глаза	ω	Наименьший угол, под которым некорригированный глаз видит две точки раздельно
41. Угловое разрешение корригированного глаза	ω_2	Наименьший угол, под которым полностью корригированный глаз видит две точки раздельно
42. Острота зрения некорригированного глаза	V	Белочина, обратная угловому разрешению некорригированного глаза
43. Острота зрения корригированного глаза	V_x	Белочина, обратная угловому разрешению корригированного глаза
44. Конвергенция глаза	—	Поворот зрительных осей обоих глаз внутрь при фиксации предмета, расположенного на конечном расстоянии

Продолжение табл. I


Термин	Буквенное обозначение	Определение
45. Аккомодативная конвергенция глаза	—	Изменение конвергенции, обусловленное изменением аккомодации
46. Отношение аккомодативной конвергенции к напряжению аккомодации	—	—
47. Угол конвергенции глаза	α	Угол между зрительными осями глаз при фиксации предмета, находящегося на конечном расстоянии
48. Фузионный угол	β	Угол между зрительной осью глаза в условиях конвергенции и перпендикуляром к линии, соединяющей центры вращения глаз
49. Угол поворота глаза	γ	— Приложение. Угол поворота глаз приведен на черт. I.
50. Фузия	—	Слияние изображений на сетчатках обоих глаз в единый зрительный образ
51. Гетерофория	—	Мышечное неравновесие глаз, преодолеваемое за счет фузионной способности
52. Ортофория	—	Мышечное равновесие обоих глаз. Приложение. При фиксации точки в бесконечности в случае выключения одного из глаз зрительные оси остаются параллельными

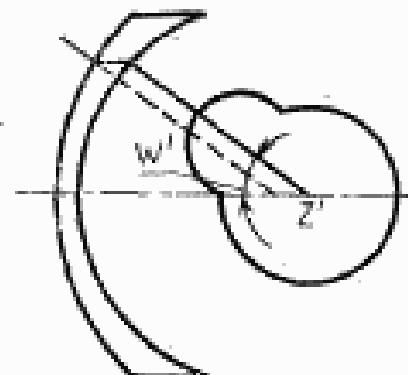

Черт. I

Продолжение табл. I


Термин	Буквенное обозначение	Определение
53. Анизейкония	—	Неравенство размеров изображений наблюдаемого предмета на сетчатках обоих глаз. П р и м е ч а н и е. Измеряется относительной разностью размеров изображений наблюдаемого предмета.
54. Анизометрия	—	Неравенство аметрий обоих глаз
55. Бинокулярное зрение	—	Зрение двумя глазами, при котором воспринимается единый зрительный образ
56. Зрительная адаптация	—	Процесс приспособления глаз к различным уровням яркости
57. Рефракционное равновесие глаз	—	Состояние глаз при бинокулярном зрении, при котором с коррекцией или без нее на обеих сетчатках глаз получаются резкие изображения
58. Поле зрения глаза	—	Пространство, в пределах которого совокупность точек воспринимается при неподвижных глазах и голове
59. Поле обзора глаза	—	Пространство, в пределах которого совокупность точек воспринимается подвижным глазом при неподвижной голове
60. Градусная схема ТАБО	—	Градусная схема для обозначений направления главных сечений астигматического глаза, астигматической линзы, а также базы призматической линзы. П р и м е ч а н и е. Градусная схема ТАБО приведена на черт. 2.

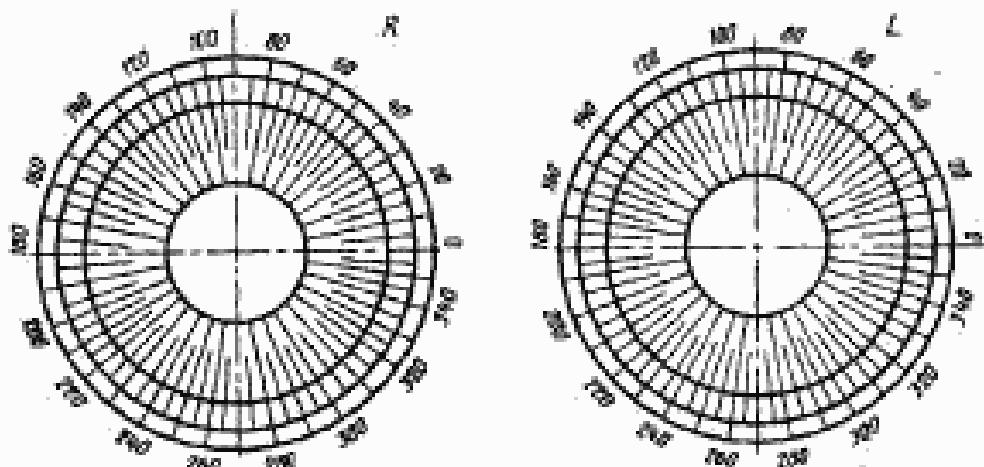

R — правый глаз;
L — левый глаз

Черт. 2

Продолжение табл. 1

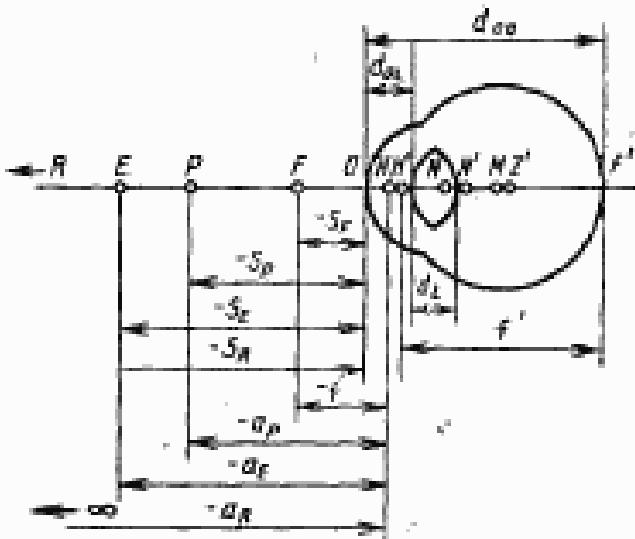Термин	Буквенное обозначение	Определение
61. Эмметропический глаз	—	<p>Глаз, задний фокус которого находится на сетчатке</p> <p>П р и м е ч а н и е. Дальнейшая точка эмметропического глаза находится в бесконечности</p>
62. Схематический глаз	—	<p>Модель эмметропического глаза человека как оптического прибора, параметры элементов которой соответствуют средним значениям величин реального глаза.</p> <p>П р и м е ч а н и е. Схематический глаз приведен на черт. 3.</p>  <p>The diagram illustrates a schematic eye model. A horizontal axis represents the optical axis. Key points labeled include: R (refraction point), E (entry pupil), P (pupil), F (exit pupil), O (anterior vertex of the cornea), H, H' (front and back principal points), N, N' (front and back nodal points), f, f' (front and back focal points), and i, i' (front and back conjugate distances). The distance from the anterior vertex to the lens is d_L, and the total length of the eye is d_{zz}. Various other parameters like $s_R, s_P, s_E, s_N, s_f, d_R, d_F$ are also indicated.</p>
63. Редуцированный глаз	—	<p>H, H' — передняя, задняя главные точки; N, N' — передняя, задняя узловые точки; f, f' — передний, задний фокусы; i, i' — переднее, заднее фокусные расстояния O — передняя вершина роговицы</p> <p>Черт. 3.</p>
64. Оптический центр вращения глаза	Z'	<p>Упрощенная модель схематического глаза, имеющая только одну преломляющую поверхность, разделяющую две среды: воздух и стекловидное тело (согласно Гиффену)</p> <p>Неподвижная точка внутри глаза, вокруг которой глаз вращается при изменении направления взгляда.</p> <p>П р и м е ч а н и е. Оптический центр вращения схематического глаза находится на расстоянии 14,43 мм от передней вершины роговицы</p>

3*


Продолжение табл. I

Термин	Буквенное обозначение	Определение
65. Центр глаза	M	Геометрический центр глаза, условно принимаемого за шар без учета выступающей части роговицы.
		П р и м е ч а н и е. Центр схематического глаза находится на расстоянии 13,1 мм от передней вершины роговицы
66. Оптическая ось схематического глаза	—	Прямая, проходящая через центры кривизны преломляющих поверхностей схематического глаза
67. Аметропический глаз	—	Глаз, задний фокус которого не находится на сетчатке
68. Миопический глаз	—	Аметропический глаз, задний фокус которого находится перед сетчаткой.
		П р и м е ч а н и е. Дальнейшая точка миопического глаза находится на конечном расстоянии перед глазом
69. Гиперметропический глаз	—	Аметропический глаз, задний фокус которого находится позади сетчатки.
		П р и м е ч а н и е. Дальнейшая точка гиперметропического глаза минима и находится за сетчаткой
70. Пресбиопический глаз	—	Глаз, утративший с возрастом частично или полностью аккомодационную способность
71. Амблиопический глаз	—	Глаз с пониженной остротой зрения (0,01—0,30), которая обусловлена функциональными расстройствами зрительного анализатора и не повышается с помощью оптических средств коррекции
72. Афакический глаз	—	Глаз, у которого отсутствует хрусталик
73. Артифактический глаз	—	Глаз с искусственным хрусталиком
74. Расстояние наилучшего зрения	—	Наиболее удобное расстояние от глаза до рассматриваемого предмета при работе вблизи.
		П р и м е ч а н и е. В офтальмологической оптике оно принимается равным 300—350 мм, в вычислительной оптике — 250 мм
ОЧКОВАЯ ЛИНЗА		
75. Рефракция очковой линзы	F*	Величина, обратная заднему фокусному расстоянию очковой линзы в метрах
76. Передняя вершинная рефракция очковой линзы	F _V	Величина, обратная переднему фокальному отрезку очковой линзы в метрах

Продолжение табл. 1


Термин	Буквенное обозначение	Определение
77. Задняя вершинная рефракция очковой линзы	F'_{v}	По ГОСТ 24052
78. Задняя вершинная рефракция первого главного сечения астигматической линзы	F'_{v1}	По ГОСТ 24052
79. Задняя вершинная рефракция второго главного сечения астигматической линзы	F'_{v2}	По ГОСТ 24052
80. Добавочная задняя вершинная рефракция зоны для близи многофокальной очковой линзы	F'_{vz}	Алгебраическая разность задних вершинных рефракций зон для близи и для дали многофокальной очковой линзы
81. Добавочная задняя вершинная рефракция промежуточной зоны многофокальной очковой линзы	F'_{vt}	Алгебраическая разность задних вершинных рефракций промежуточной зоны и зоны для дали многофокальной очковой линзы
82. Астигматическая разность рефракций очковой линзы	—	По ГОСТ 24052

Продолжение табл. I

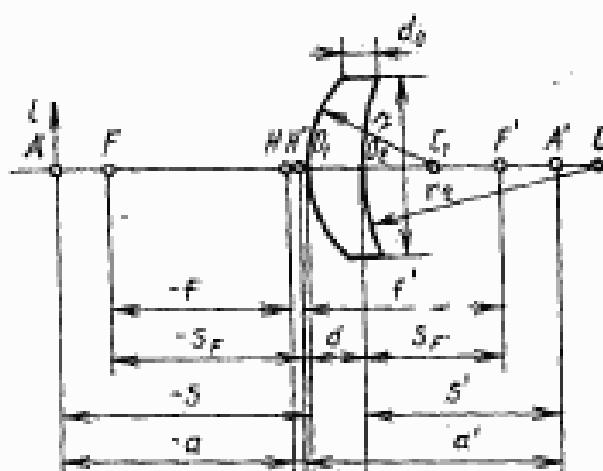Термин	Буквенное обозначение	Определение
83. Диаметр очковой линзы	D	— Примечание. Диаметр очковой линзы указан на черт. 4.
		
		H, H' — передняя, задняя главные точки; O_1, O_2 — передняя, задняя вершины; F, F' — передний, задний фокусы; j, j' — переднее, заднее фокусные расстояния; c_1, c_2 — центры кривизны; r_1, r_2 — радиусы кривизны.
		Черт. 4.
84. Толщина очковой линзы по центру	d	Расстояние между сферическими поверхностями очковой линзы по оптической оси
85. Толщина очковой линзы по краю	d_4	Расстояние между сферическими поверхностями по краю очковой линзы
86. Собственное увеличение очковой линзы	N	Отношение задней вершинной рефракции к рефракции очковой линзы
87. Положение базы призматической линзы по шкале ТАБО	Θ	—
88. Передняя склонность очковой линзы	A	Величина, обратная расстоянию в метрах от передней главной точки очковой линзы до осевой точки предмета
89. Задняя склонность очковой линзы	A'	Величина, обратная расстоянию в метрах от задней главной точки очковой линзы до осевой точки изображения предмета

Продолжение табл. I

Термин	Буквенное обозначение	Определение
90. Оптический центр очковой линзы	O	По ГОСТ 24052
91. Геометрический центр очковой линзы	O	По ГОСТ 24052
92. Номинальный центр очковой линзы	B	По ГОСТ 24052
93. Децентрация очковой линзы	c	По ГОСТ 24052
94. Горизонталь очковой линзы	—	Прямая, проходящая через номинальный центр и определяющая нулевое положение главных сечений астигматической очковой линзы и базы прематической очковой линзы
95. Вершина линии раздела многофокальной очковой линзы	T	— Приложение. Вершина линии раздела многофокальной очковой линзы указана на черт. 5.
96. Горизонтальное смещение зоны для близи многофокальной очковой линзы	e	По ГОСТ 24052
97. Вертикальное смещение линии раздела	f	По ГОСТ 24052
98. Угол поворота зоны для близи бифокальной очковой линзы	γ	Угол между горизонталью очковой линзы и перпендикулярном к линии, связывающей номинальные центры зон для дали и для близи бифокальной очковой линзы

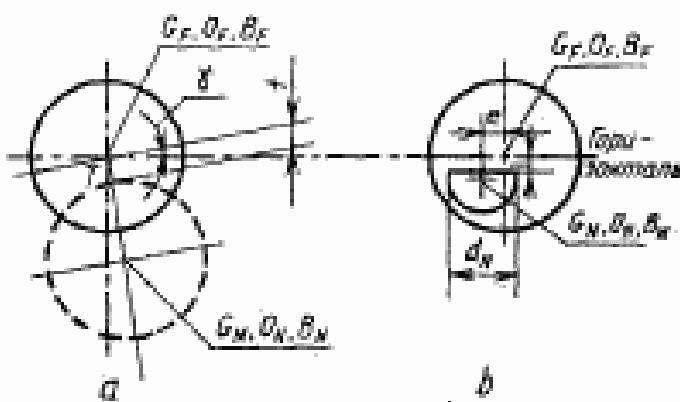

Черт. 5

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение	Определение
99. Сферическое действие очковой линзы	<i>S</i>	Действие очковой линзы, определяемое рефракцией сферической линзы или сферического компонента астигматической линзы
100. Цилиндрическое действие очковой линзы	<i>C</i>	Действие очковой линзы, определяемое рефракцией цилиндрической линзы или астигматической разностью астигматической линзы
101. Призматическое действие очковой линзы	<i>P_r</i>	<p>Отклонение светового луча, проходящего через призматическую или десентрированную очковую линзу, от первоначального его направления.</p> <p>П р и м е ч а н и е. Призматическое действие десентрированной очковой линзы в сантирадианах определяется по формуле</p> $P_r = P' \cdot c, \quad (2)$ <p>где P' — рефракция очковой линзы, дптр;</p> <p>c — десентрация очковой линзы, см</p>

**ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, АППАРАТЫ И
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ
ОРГАНА ЗРЕНИЯ**

102. Гониолинза	—	Устройство для визуального исследования угла передней камеры глаза, использующее оптические преломляющие средства
103. Гониоскоп	—	Устройство для визуального исследования угла передней камеры глаза, использующее оптические отражающие средства
104. Диафазоскоп	—	Устройство для просвечивания глазного яблока
105. Поляризационный макулотестер	—	Аппарат для исследования поляризационных свойств желтого пятна и переноса зрительной фиксации, близкой к центральной, в центральную
106. Офтальмосвектоагулятор	—	Аппарат для коагулирования тканей глаза с помощью светового излучения
107. Офтальмоскоп	—	Прибор для исследования глазного дна и прозрачности преломляющих сред глаза
108. Офтальмоскопическая линза	—	Линза для наблюдения глазного дна
109. Фундускамера	—	Прибор для фотoreгистрации изображения глазного дна
110. Щелевая лампа	—	Прибор для биомикроскопии глаза
111. Эзофтальмометр	—	Прибор для измерения степени выступания или западания глазного яблока

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение	Определение
112. Электроофтальмограф	—	Регистрирующий прибор для измерения зависимости разности потенциалов электрического поля глаза, возникающей при движении глазного яблока, от времени
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ЗРЕНИЯ		
113. Адаптометр	—	Прибор для измерения световой чувствительности глаза и исследования процесса темновой адаптации
114. Аккомодометр	—	Прибор для измерения напряжения аккомодации глаза
115. Аномалоскоп	—	Прибор для исследования цветовой чувствительности глаза и аномалий цветового зрения
116. Кампиметр	—	Прибор для измерения поля зрения на плоском экране
117. Периметр	—	Прибор для измерения поля зрения на сферическом экране
118. Офтальмогрометр	—	Прибор для определения рабочих зон аккомодации и оценки утомляемости аккомодации
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГЛАЗА, ПОДБОРД И КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ		
119. Автокератометр	—	Прибор для автоматизированного измерения кривизны роговицы и расчета конструкции роговничной контактной линзы
120. Астигматометр	—	Устройство из цилиндрических линз для определения астигматизма путем плавного изменения значения и знака астигматической разности рефракций линз
121. Глазной рефрактометр	—	Прибор для измерения аметропии глаза
122. Диоптрииметр	—	Прибор для измерения задней вершинной рефракции, призматического действия, направления главных сечений астигматических линз, базы призматической линзы и положения оптического центра очковых линз
123. Кератометр	—	Прибор для измерения диаметра передней поверхности роговицы и зрачка глаза, а также расстояния между роговицей и очковой линзой
124. Офтальмометр	—	Прибор для измерения радиуса кривизны, рефракции и астигматизма передней поверхности роговицы, а также направления главных сечений астигматической роговицы

Продолжение табл. I

Термин	Буквенное обозначение	Определение
125. Пробная оправа	—	Устройство для установки пробных очковых линз при подборе корригирующих очков
126. Пробная очковая линза	—	Линза для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы
127. Скнаскоп	—	Прибор для определения аметропии глаза путем наблюдения за перемещением светового пятна в освещенном зрачке
128. Скнаскопическая линейка	—	Устройство с корригирующими линзами, применяемое при скнаскопии
129. Скрещенные цилиндры	—	Устройство для уточнения цилиндрического компонента и положения его главных сечений при определении астигматизма
130. Фороптер	—	Устройство для механизированной смены линз при подборе корригирующих очков методом субъективной пробы
131. Центрископ	—	Прибор для определения центрировки линз корригирующих очков относительно зрачков пациента

**ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, АППАРАТЫ И УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ**

132. Амблиоскоп	—	Прибор для исследования мышечного баланса и подвижности глаз, фузионной способности
133. Амблистрениер	—	Аппарат для тренировки и восстановления ослабленного зрения, обусловленного функциональными расстройствами зрительного анализатора
134. Анизейкометр	—	Прибор для измерения анизейкомии
135. Конвергенттрениер	—	Аппарат для исследования и тренировки конвергентных движений глаз
136. Мускулатренер	—	Аппарат для исследования и развития подвижности глаз
137. Призменный офтальмокомпенсатор	—	Устройство для определения угла косоглазия, определения и развития фузионных резервов путем плавного изменения значения призматического действия
138. Синоптофор	—	Прибор для исследования и лечения нарушений бинокулярного зрения, обусловленных косоглазием

Продолжение табл. I

Термин	Буквенное обозначение	Определение
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ ГЛАЗА		
139. Офтальмоманометр	—	<p>Показывающий прибор с выводом измерительной информации на шкалу или цифровой индикатор для измерения внутриглазного давления.</p> <p>Примечание. Измерения проводятся по деформации глаза при постоянной силе, действующей на него, или по силе при его постоянной деформации.</p>
140. Офтальмоманограф	—	<p>Регистрирующий прибор для измерения зависимости внутриглазного давления от времени.</p> <p>Примечание. Измерения проводятся по деформации глаза при постоянной силе, действующей на него, или по силе при его постоянной деформации.</p>

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Таблица 2

Термин	Номер термина
Автокератометр	119
Адаптометр	113
Адаптация зрительная	56
Аккомодация глаза	8
Аккомодометр	114
Амблиоскоп	132
Амблиотренер	133
Аметропия	5
Анизейкония	53
Анизейкониметр	134
Анизометропия	54
Аномалоскоп	115
Астигматизм глаза	23
Астигмокорректор	120
Вершина линзы раздела линзы очковой многофокальной	95
Гетерофория	51
Глаз амблиопический	71
Глаз аметропический	67
Глаз артифактический	73
Глаз афакический	72
Глаз гиперметропический	69
Глаз миопический	68
Глаз пресбиопический	70
Глаз редуцированный	63
Глаз схематический	62
Глаз эмметропический	61
Глубина передней камеры	28
Гониолинза	102
Гониоскоп	103
Горизонталь линзы очковой	94
Действие призматическое линзы очковой	101
Действие сферическое линзы очковой	99
Действие цилиндрическое линзы очковой	100
Децентрация линзы очковой	93
Диаметр входного зрачка глаза	24
Диаметр линзы очковой	83
Диафаноскоп	104
Диоптриметр	122
Длина глаза оптическая	30
Зрение бинокулярное	55
Кампиметр	116
Кератометр	123
Конвергенция	44
Конвергенция глаза	44
Конвергенция глаза аккомодативная	45
Конвергентрендер	135
Лампа щелевая	110
Линейка сканскопическая	128
Линза офтальмоскопическая	108
Линза очковая пробная	126

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Макулотестер поляризационный	105
Мускултренер	136
Напряжение аккомодации глаза	16
Напряжение аккомодации глаза максимальное	11
Область аккомодации глаза	19
Объем аккомодации глаза	20
Объем аккомодации корrigированного глаза	21
Оправа пробная	125
Оптика очковая	2
Оптика офтальмологическая	1
Ортофория	52
Острота зрения корrigированного глаза	43
Острота зрения некорrigированного глаза	42
Ось зрительная	22
Ось глаза схематического оптической	66
Отношение аккомодативной конвергенции к напряжению аккомодации	46
Отношение АКА	46
Офтальмосветокоагулятор	106
Офтальмокомпенсатор призменный	137
Офтальмометр	124
Офтальмоскоп	107
Офтальмогониометр	139
Офтальмогонограф	140
Офтальмогонгометр	118
Периметр	117
Поле зрения глаза	58
Поле обзора глаза	59
Положение базы призматической линзы по шкале ТАБО	87
Равновесие рефракционное глаз	57
Размер предмета видимый угловой	39
Разность рефракций линзы очковой астигматическая	82
Разрешение глаза корrigированного угловое	41
Разрешение глаза некорrigированного угловое	40
Расстояние межзрачковое для близи	34
Расстояние межзрачковое для дали	31
Расстояние наилучшего зрения	74
Рефрактометр глазной	121
Рефракция линзы очковой вершинная задняя	77
Рефракция линзы очковой вершинная передняя	76
Рефракция зоны для близи линзы очковой многофокальной вершинная задняя добавочная	80
Рефракция зоны промежуточной линзы очковой многофокальной вершинная задняя добавочная	81
Рефракция первого главного сечения астигматической линзы задняя вершинная	78
Рефракция второго главного сечения астигматической линзы задняя вершинная	79
Рефракция линзы очковой	75
Симоптофор	138
Синаскоп	127

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Смещение зоны для близи линзы очковой многофокальной горизонтальное	96
Смещение линии раздела вертикальное	97
Схема градусная ТАБО	60
Сходимость задняя линзы очковой	89
Сходимость передняя линзы очковой	88
Толщина линзы очковой по краю	85
Толщина линзы очковой по центру	84
Толщина роговицы	27
Толщина хрусталика глаза	29
Точка ясного зрения ближайшая	9
Точка ясного зрения дальнейшая	3
Точка фиксации глаза	14
Увеличение линзы очковой собственное	86
Угол конвергенции глаза	47
Угол поворота глаза	49
Угол поворота зоны для близи линзы очковой бифокальной	98
Угол фузионный	48
Фороптер	130
Фузия	50
Фундус-камера	109
Центр вращения глаза оптический	64
Центр глаза	65
Центр линзы очковой геометрический	91
Центр линзы очковой номинальный	92
Центр линзы очковой оптический	90
Центрископ	131
Цилиндры скрещенные	129
Экзофтальмометр	111
Электроофтальмограф	112

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Таблица 3

Буквенное обозначение	Номер термина
Латинский алфавит	
<i>A</i> — передняя сходимость очковой линзы	88
<i>A'</i> — задняя сходимость очковой линзы	89
<i>A_в</i> — напряжение аккомодации глаза	16
<i>A_р</i> — максимальное напряжение аккомодации глаза	11
<i>A_{РК}</i> — объем аккомодации глаза	20
<i>A_{РК, к}</i> — объем аккомодации корректированного глаза	21
<i>A_р</i> — аметропия	5
<i>A_з</i> — астигматизм глаза	23
<i>a_к</i> — расстояние от передней главной точки глаза до точки фиксации	15
<i>a_р</i> — расстояние от передней главной точки глаза до ближайшей точки ясного зрения	10
<i>a_{у_к}</i> — область аккомодации глаза	19
<i>a_в</i> — расстояние от передней точки глаза до дальнейшей точки ясного зрения	4
<i>B</i> — номинальный центр очковой линзы	92
<i>C</i> — цилиндрическое действие очковой линзы	100
<i>c</i> — децентрация очковой линзы	93
<i>D</i> — диаметр очковой линзы	83
<i>D_р</i> — диаметр входного зрачка глаза	24
<i>d</i> — толщина очковой линзы по центру	84
<i>d_с</i> — толщина роговицы	27
<i>d₀</i> — толщина очковой линзы по краю	85
<i>d_{OL}</i> — глубина передней камеры глаза	28
<i>d_{оп}</i> — оптическая длина глаза	30
<i>d_L</i> — толщина хрусталика глаза	29
<i>d_р</i> — расстояние от передней вершинны роговицы до центра входного зрачка	25
<i>d_{z_р}</i> — расстояние от передней вершинны роговицы до центра вращения глаза	26
<i>E</i> — точка фиксации глаза	14
<i>e</i> — горизонтальное смещение зоны для близи многофокальной очковой линзы	96
<i>F</i> — рефракция очковой линзы	75
<i>F_в</i> — передняя вершинная рефракция очковой линзы	76
<i>F'_в</i> — задняя вершинная рефракция очковой линзы	77
<i>F'_{в₁}</i> — задняя вершинная рефракция первого главного сечения астигматической очковой линзы	78
<i>F'_{в₂}</i> — задняя вершинная рефракция второго главного сечения астигматической очковой линзы	79



Продолжение табл. 3

Буквенное обозначение	Номер термина
F'_{vT} — добавочная задняя вершинная рефракция промежуточной зоны многофокальной очковой линзы	81
F'_{vZ} — добавочная задняя вершинная рефракция зоны для близи многофокальной очковой линзы	80
G — геометрический центр очковой линзы	91
M — центр глаза	65
N — собственное увеличение очковой линзы	86
O — оптический центр очковой линзы	90
P — ближайшая точка ясного зрения	9
P_T — призматическое действие очковой линзы	101
r_F — межзрачковое расстояние для дали	31
$R_{F,L}$ — расстояние от середины переноса до центра зрачка левого глаза при зрении вдаль	33
$R_{F,R}$ — расстояние от середины переноса до центра зрачка правого глаза при зрении вдаль	32
r_N — межзрачковое расстояние для близи	34
$R_{N,L}$ — расстояние от середины переноса до центра зрачка левого глаза при зрении на расстоянии наилучшего зрения	36
$R_{N,R}$ — расстояние от середины переноса до центра зрачка правого глаза при зрении на расстоянии наилучшего зрения	35
R — дальнейшая точка ясного зрения	3
S — сферическое действие очковой линзы	99
S_B — величина, обратная расстоянию в метрах от передней вершины роговицы глаза до точки фиксации глаза	18
s_E — расстояние от передней вершины роговицы глаза до точки фиксации глаза	17
S_F — величина, обратная расстоянию в метрах от передней вершины роговицы глаза до ближайшей точки ясного зрения	13
s_P — расстояние от передней вершины роговицы глаза до дальнейшей точки ясного зрения	12
S_B — величина, обратная расстоянию в метрах от передней вершины роговицы глаза до дальнейшей точки ясного зрения	7
s_E — расстояние от передней вершины роговицы глаза до дальнейшей точки ясного зрения	6
T — вершина линки раздела многофокальной очковой линзы	95
t — вертикальное смещение линки раздела многофокальной очковой линзы	97
V — острота зрения некорректированного глаза	42
V_k — острота зрения корректированного глаза	43
w' — угол поворота глаза	49
Z' — оптический центр вращения глаза	64

Продолжение табл. 3

Буквенное обозначение	Номер термина
Греческий алфавит	
α — угол конвергенции	47
γ — угол поворота зоны для близи бифокальной очковой линзы	99
b — расстояние от задней главной точки очковой линзы до передней главной точки глаза	37
b' — расстояние от задней вершины очковой линзы до передней вершине роговицы	38
ψ — фузионный угол	46
θ — положение базы призматической очковой линзы по шкале TABO	87
ω — угловое разрешение некорrigированного глаза	40
ω_k — угловое разрешение корrigированного глаза	41
ω_1 — видимый угловой размер предмета	39

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИКЕ

Таблица 4

Термин	Буквенное обозначение	Пояснение
1. Рефракция преломляющей поверхности	—	Рефракцию отдельной поверхности определяют по формуле $F_1' = \frac{n_1' - n_1}{r_1} , \quad (3)$ где n_1 — показатель преломления среды в пространстве предметов; n_1' — показатель преломления среды в пространстве изображений; r_1 — радиус кривизны поверхности
2. —	a	Расстояние от передней главной точки до осевой точки предмета
3. —	a'	Расстояние от задней главной точки до осевой точки изображения



Продолжение табл. 4

Термин	Буквенное обозначение	Пояснение
4. —	s	Расстояние от передней вершины преломляющей поверхности до осевой точки предмета
5. —	s'	Расстояние от задней вершины, преломляющей поверхности до осевой точки изображения
6. —	S	Величина, обратная расстоянию в метрах от передней вершины преломляющей поверхности до осевой точки предмета
7. —	S'	Величина, обратная расстоянию в метрах от задней вершины преломляющей поверхности до осевой точки изображения
8. Меридиональное сечение	—	Сечение, содержащее оптическую ось и вноосовую точку предмета
9. Сагиттальное сечение	—	Сечение, перпендикулярное меридиональному сечению и проходящее через ось симметрии пучка
10. Размер предмета	I	См. черт. 4
11. Размер изображения предмета	I'	См. черт. 4
12. Линейное увеличение	β	Отношение размеров изображений к размерам предмета

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИКЕ

Таблица 5

Единица измерения	Обозначение	Пояснение
Диоптрия Сантирадиан	дптр срад	<p>Величина, обратная отрезку длиной в 1 м По ГОСТ 8.417</p> <p>Приложения:</p> <p>1. 1 срад равен 1 призменной диоптрии (предптр).</p> <p>2. Призматическое действие в 1 срад равно отклонению светового луча на 1 см на экране, расположенному перпендикулярно падающему лучу на расстоянии 1 м от вершины угла отклонения</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

**ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИКЕ**

$$F_1 = \frac{n-1}{r_1}, \quad (4)$$

где F_1 — рефракция передней поверхности линзы, дптр;
 n — показатель преломления линзы;
 r_1 — радиус передней поверхности линзы, м.

$$F_2 = \frac{1-n}{r_2}, \quad (5)$$

где F_2 — рефракция задней поверхности линзы, дптр;
 n — показатель преломления линзы;
 r_2 — радиус задней поверхности линзы, м.

$$F' = F_1 + F_2 - \frac{d}{n} \cdot F_1 \cdot F_2, \quad (6)$$

где F' — рефракция линзы, дптр;
 F_1 — рефракция передней поверхности линзы, дптр;
 F_2 — рефракция задней поверхности линзы, дптр;
 d — толщина линзы, м;
 n — показатель преломления линзы

$$A' = A + F', \quad (7)$$

где A' — задняя сходимость, дптр;
 A — передняя сходимость, дптр;
 F' — рефракция линзы, дптр

$$F'_V = \frac{1}{s'_P}, \quad F'_V = \frac{F'}{1 - \frac{d}{n} F_1}, \quad (8)$$

где F'_V — задняя вершинная рефракция очковой линзы, дптр;
 s'_P — задний фокальный отрезок очковой линзы, м;
 F' — рефракция очковой линзы, дптр;
 d — толщина очковой линзы по центру, м;
 n — показатель преломления очковой линзы;
 F_1 — рефракция передней поверхности очковой линзы, дптр.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ИСПОЛНИТЕЛИ

Б. В. Овчинников, канд. техн. наук (руководитель темы);
Л. В. Кривошапова; Р. Н. Шверикас; Л. С. Иутинская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по стандартам от 28.10.88
№ 3599

3. Срок первой проверки — I квартал 1998 г., периодичность про-
верки — 10 лет.

4. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 6147—87

5. Взамен ГОСТ 14934—80

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-
ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8.417—81	Приложение 2
ГОСТ 24052—80	77, 82, 90, 91, 92, 93, 96, 97

Редактор *М. Е. Искандарян*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 28.11.88 Полл. в печ. 23.01.89 1,75 усл. ш. л. 1,75 усл. кр.-отт. 1,74 усл.-изд. л.
Тираж 6 000 Цена 10 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 3248